RESPIRONICS

REMstar® *Auto*

M Series com A-Flex™

GUIA BÁSICO DE CONFIGURAÇÃO DO FORNECEDOR

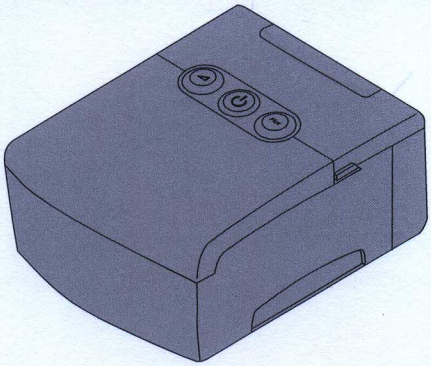

IMPORTANTE: Retire este Guia antes de fornecer o dispositivo ao paciente. Apenas profissionais da área médica devem fazer ajustes de pressão.

Este Guia fornece instruções básicas sobre como navegar nos menus de dados e de configuração do fornecedor para modificar as configurações do dispositivo. Consulte o manual do fornecedor do dispositivo para obter mais informações.

ACESSO ÀS TELAS DO MODO DE FORNECEDOR

O acesso ao modo de fornecedor desbloqueia as configurações adicionais que não podem ser modificadas pelo usuário. Para acessar o modo de fornecedor:

1. Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e a uma tomada elétrica.
2. Mantenha pressionados os botões esquerdo e direito ◀ ▶ conectando, simultaneamente, a fonte de alimentação ao dispositivo. O dispositivo estará no modo de fornecedor quando emitir dois bipes, e você poderá liberar os botões. Será exibida a tela de Espera do modo de fornecedor (mostrada na próxima página).

Você pode verificar e modificar as configurações da prescrição usando as telas de Configuração do fornecedor e visualizar os dados sobre o uso do dispositivo nas telas de Dados do fornecedor.

NAVEGAÇÃO NOS MENUS DE DADOS E DE CONFIGURAÇÃO DO FORNECEDOR

Para navegar nas telas de exibição da tela de espera do modo de fornecedor:

- Pressione o botão ⊕ para acessar o menu de Configuração do fornecedor (figura 1).
- Pressione o botão ▶ ou ◀ para acessar o menu de Dados do fornecedor (figura 2).
- Use o botão ▶ para ir para a tela seguinte e o botão ◀ para voltar à tela anterior.
- Use os botões ⊕ e ⊖ para ajustar as configurações nas telas de configuração.

Observação: *quando você terminar de fazer as modificações nas configurações, pressione o botão* ⏻ *para sair do modo de fornecedor e retornar ao modo de usuário.*

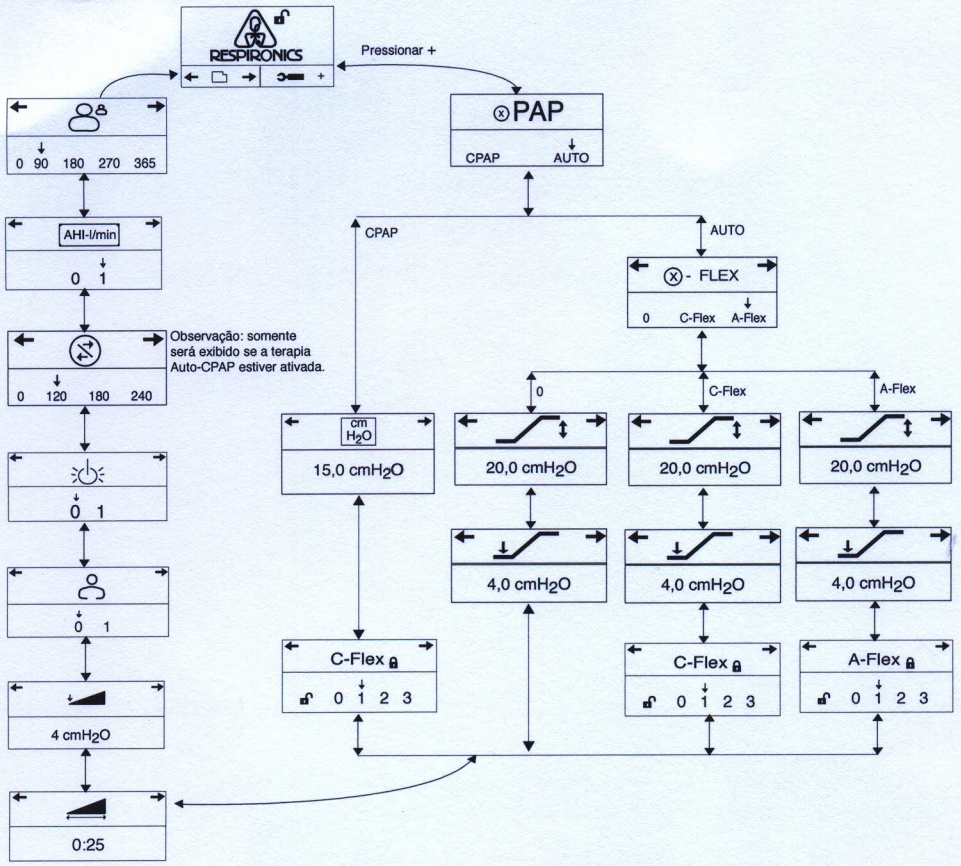

FIGURA 1 - TELAS DE CONFIGURAÇÃO DO FORNECEDOR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS SOBRE CONFIGURAÇÃO

- **Alerta de máscara**: esse alerta indicará que o dispositivo detectou um vazamento na máscara. Ative ou desative o alerta.
- **Noite dividida**: essa configuração indica o tempo gasto na terapia CPAP antes de passar para a terapia Auto-CPAP (Desligado, 120, 180 ou 240 minutos).
- AHI-LPM **Mostrar IAH/Vazamento**: selecione se o índice de apnéia/hipopnéia e as médias de vazamento do sistema serão ou não exibidos nas telas de dados do paciente.
- **Lembrete ao paciente**: com o software Encore® Pro, você pode definir uma mensagem de texto personalizada que será exibida periodicamente para o usuário. Essa tela permite especificar a freqüência de exibição do lembrete (a cada 90 dias, 180 dias, etc.).

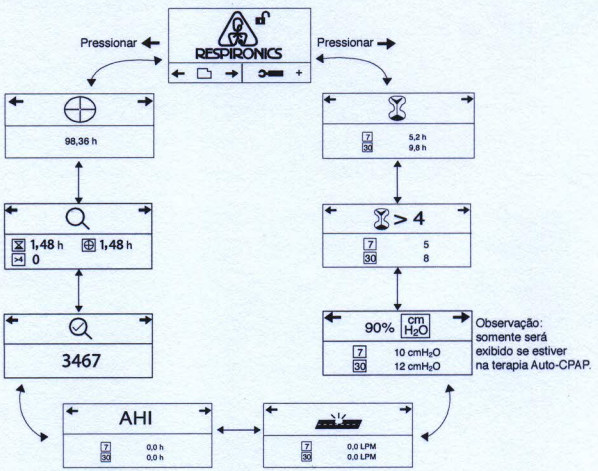

FIGURA 2 - TELAS DE DADOS DO FORNECEDOR

RESPIRONICS®
1001 Murry Ridge Lane
Murrysville, PA 15668
www.respironics.com

Respironics Deutschland
Gewerbestrasse 17
8221 Herrsching, Germany

CE 0123

1045376
GK 2/7/2007
PT-BR